


KOD KATALOGOWY	COMPLEX/2R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	COMPLEX/2R
CODE	COMPLEX/2R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	COMPLEX/2R

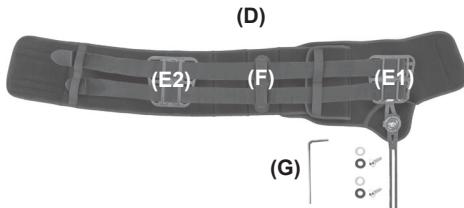

**A. Element ortezы коńczyny dolnej**

Element of the lower limb orthosis

**B. Dodatkowe elementy opasek**

Additional elements of the bands

**C. Stopa z włóknem węglowym**


Carbon foot-drop brace

**D. Kosz biodrowy / Hip basket**

**E1/E2. Szyna biodrowa z pasami i pelotami**  
/ Hip splint with belts and pelottes


**F. Przelotka / Grommet**

**G. Klucz imbusowy** / Allen key

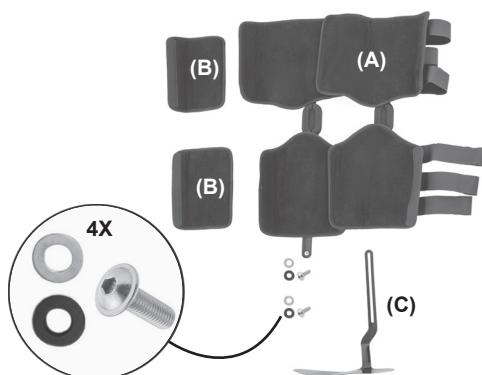


**PL: UWAGA!: Ortezę należy zakładać  
w pozycji siedzącej lub leżącej.**

**EN: ATTENTION!: The brace should be  
put on in a sitting or lying position.**

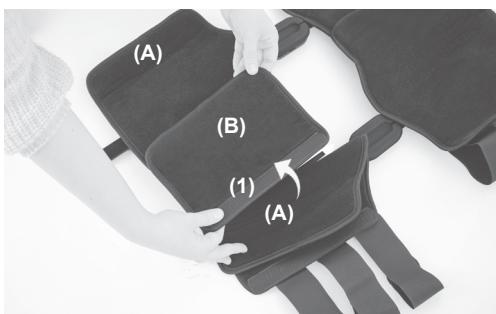


**1. PL:** Przed założeniem ortezu, rozepnij wszystkie paski i ustaw odpowiedni obwód. Jeśli istnieje potrzeba, zastosuj dodatkowe elementy opasek (B), przypinając je na rzepy (1), do elementów (A).

**EN:** Before putting on the brace, unfasten all straps and set the appropriate circumference. If there is a need, apply additional elements of the bands (B) by fastening them with Velcro (1) fasteners to the elements (A).

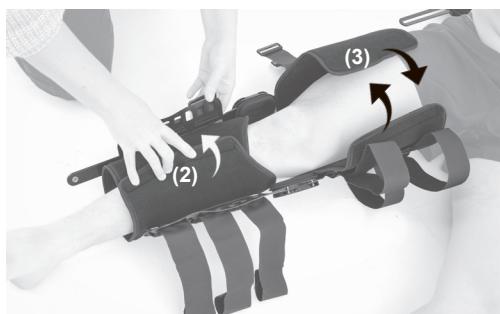

**2. PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij opaski na rzepy (2,3). Jeśli istnieje potrzeba, skoryguj ustawienia szyn bocznych.

**EN:** Put the brace on your leg and close the Velcro fasteners (2,3). If necessary, adjust the side splints.

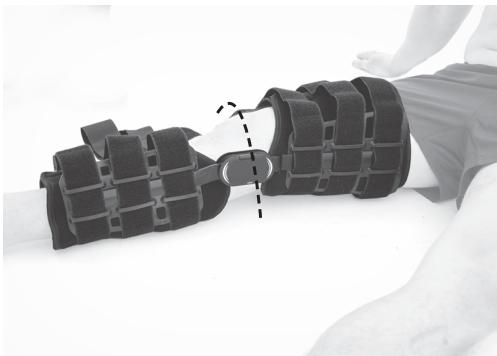




**3. PL:** Przed zapięciem pasów zegary szyn powinny być ustawione dokładnie w osi stawu kolanowego w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu.

**EN:** Before fastening the belts, the drop locks splint should be set exactly in the axis of the knee joint within the range of joint mobility specified by the physician or doctor.




**4. PL:** Przepleć taśmy (4,5,6,7,8,9) przez klamry i zapnij na rzepy w podanej kolejności. Zapinanie ortezu zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego.

**EN:** Interlace the straps (4,5,6,7,8,9) through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps. First, buckle the straps which are the closest to the knee.

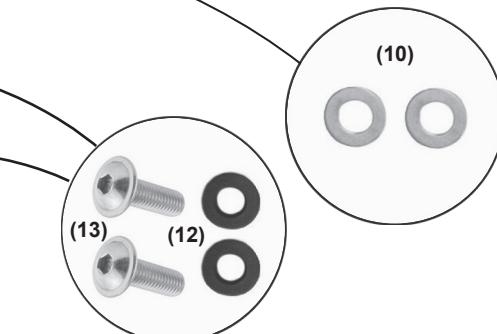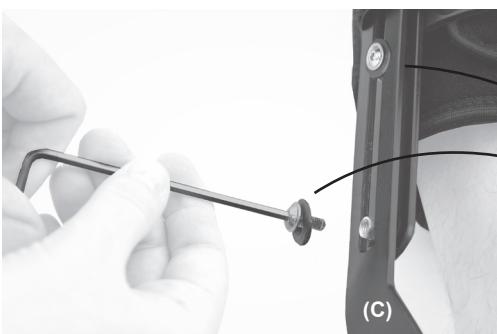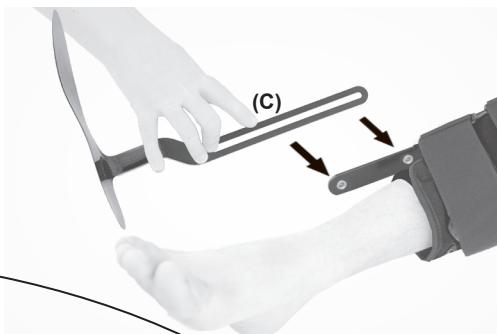


**5. PL:** Umieść podkładki metalowe (10) na nitonakrętkach (11) znajdujących się od zewnętrznej strony szyn podudzia. Nałożyć stopę z włókna węglowego (C) na nitonakrętki. Umieść podkładki z tworzywa (12) na śrubkach (13) i za pomocą klucza imbusowego przy mocuj stopę z włókna węglowego (C) do szyny podudzia.

**EN:** Place the metal elements (10) on the rivets (11) on the outside of the lower leg splint. Place the carbon foot-drop splints (C) on the rivet nuts. Place the plastic elements (12) on the screws (13) and use an Allen key to fasten the feet (C) to the leg splint.

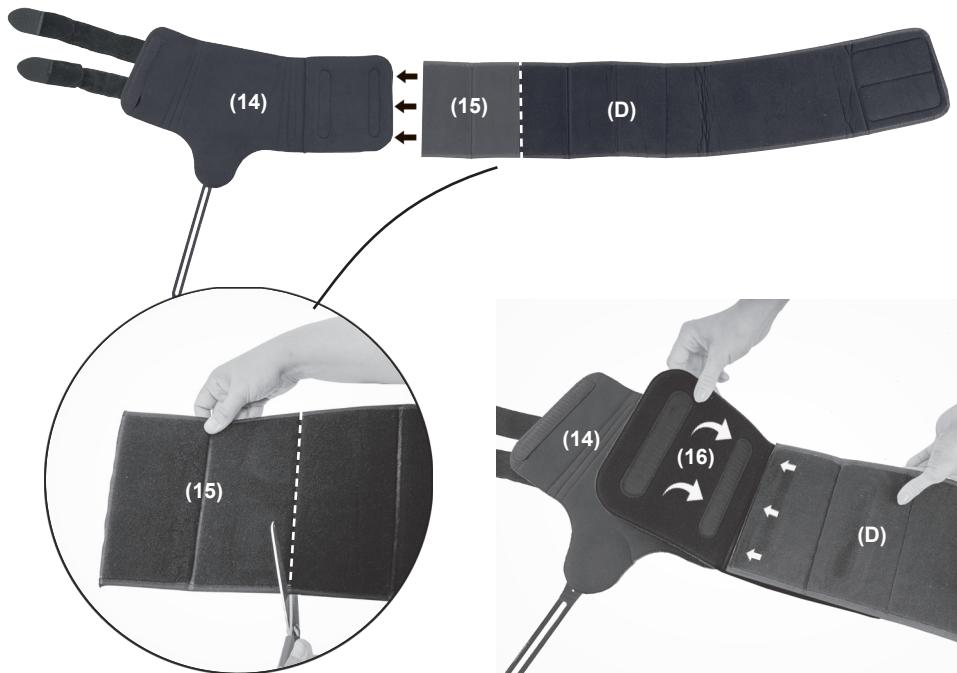


**6. PL:** Ustaw obwód pasa biodrowego (D). W tym celu odepnij od niego element łączający (14) i jeśli istnieje potrzeba, odetnij w zaznaczonych miejscach (15) zbędna długość pasa. Zapnij dopasowany pas na rzepy (16).

**EN:** Adjust the circumference of the hip belt (D). To do this, unfasten the connecting element from it (14), and if necessary, cut off the unnecessary length (15) of the strap. Close the fitted Velcro strap (16).

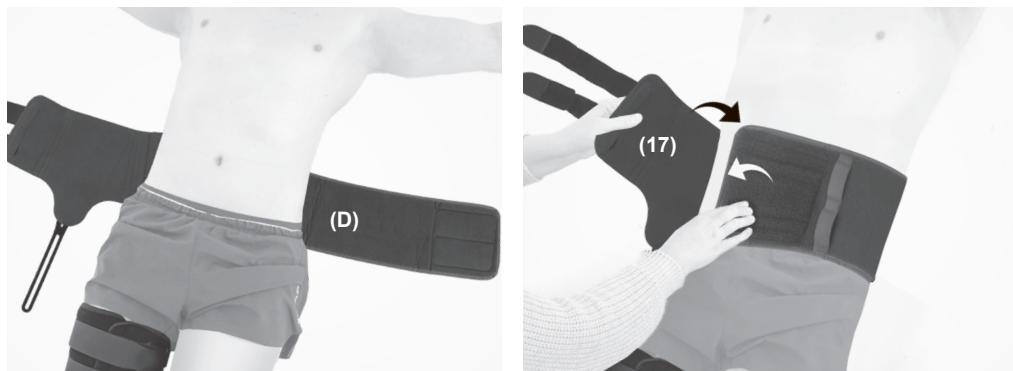

**7. PL:** Umieść tylną część ortezu (D), w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i zapnij pas na rzep (17).

**EN:** Place the back part of the brace (D) in the lumbosacral region and close the Velcro strap (17).

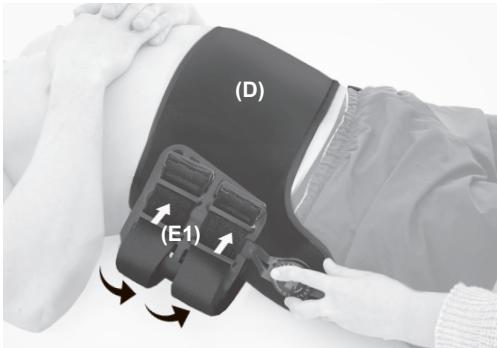


**8. PL:** Skoryguj przypięcie szyny biodrowej (E1) z wcześniej ustawionym przez lekarza prowadzącego zakresem ruchomości stawu biodrowego do kosza biodrowego (D), w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na wysokości stawu biodrowego.

**EN:** Correct the fastening of the iliac splint (E1) with the previously set by the treating physician the range of motion of the hip joint to the hip basket (D), so that the splint clock is at the height of the hip joint.




**9. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skoryguj miejsce przypięcia przelotki (F).

**EN:** If necessary, correct the position of the grommet (F).

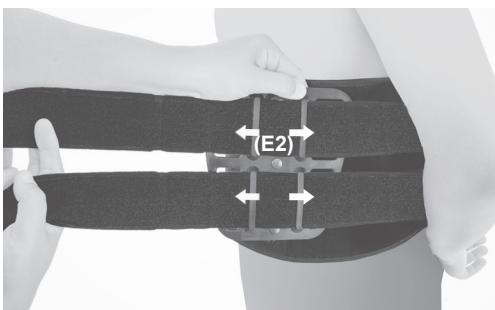


**10. PL:** Do pasa biodrowego przypnij pełotę z pasami (E2) równolegle do pełoty z szyną (E1) znajdująca się z przeciwniej strony pasa.

**EN:** Attach the pelette with the straps (E2) to the pelvic belt parallel to the pelette with the splint (E1) on the opposite side of the belt.

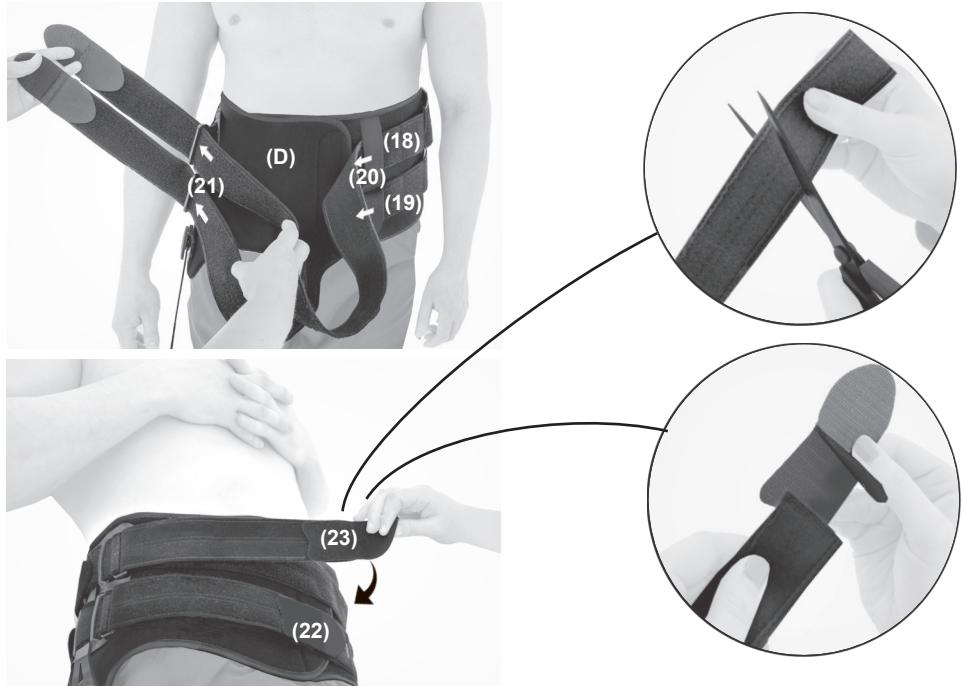

**11. PL:** Przepleć z przodu pasy (18,19) przez szlufki (20) znajdujące się w przedniej części kosza biodrowego (D). Przepleć pasy przez klamerki (21) i zapnij rzepy (22,23). Jeśli istnieje potrzeba odepnij rzepy, odetnij zopportunitàą długosć taśm i ponownie przypnij rzepy.

**EN:** Interlace the front straps (18,19) through the loops (20) on the front of the hip basket (D). Interlace the straps through the buckles (21) and fasten the Velcro fasteners (22,23). If necessary, unfasten the Velcro, cut the excess length of the straps and reattach the Velcro.

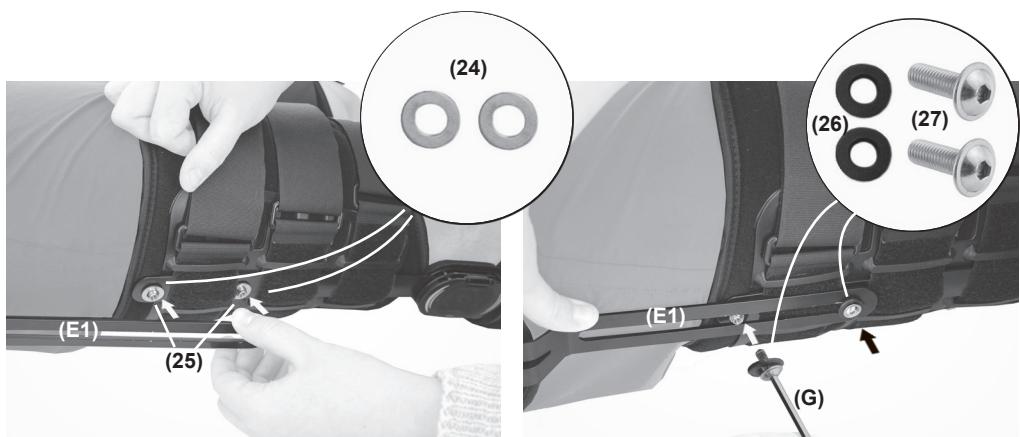

**12. PL:** Umieść podkładki metalowe (24) na nitonakrętkach (25) znajdujących się od zewnętrznej strony szyny udowej. Nalóż szynę biodrową (E1) na nitonakrętki. Umieść podkładki z tworzywa (26) na śrubkach (27) i za pomocą klucza imbusowego (G) przymocuj szynę biodrową (E1) do szyny udowej.

**EN:** Place the metal elements (24) on the thigh rivet nuts (25). Place the hip splints (E1) over the blind rivet nuts. Place the plastic elements (26) on the screws (27) and use the Allen key (G) to attach the hip splints (E1) to the thigh splints.



**13. PL:** Ustaw pacjenta w pozycji pionowej, skoryguj długości szyn pomiędzy poszczególnymi stawami oraz naprężenie pasów.

**EN:** Keeping an upright position correct the length of the splints between the joints and belt tension.

**14. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.